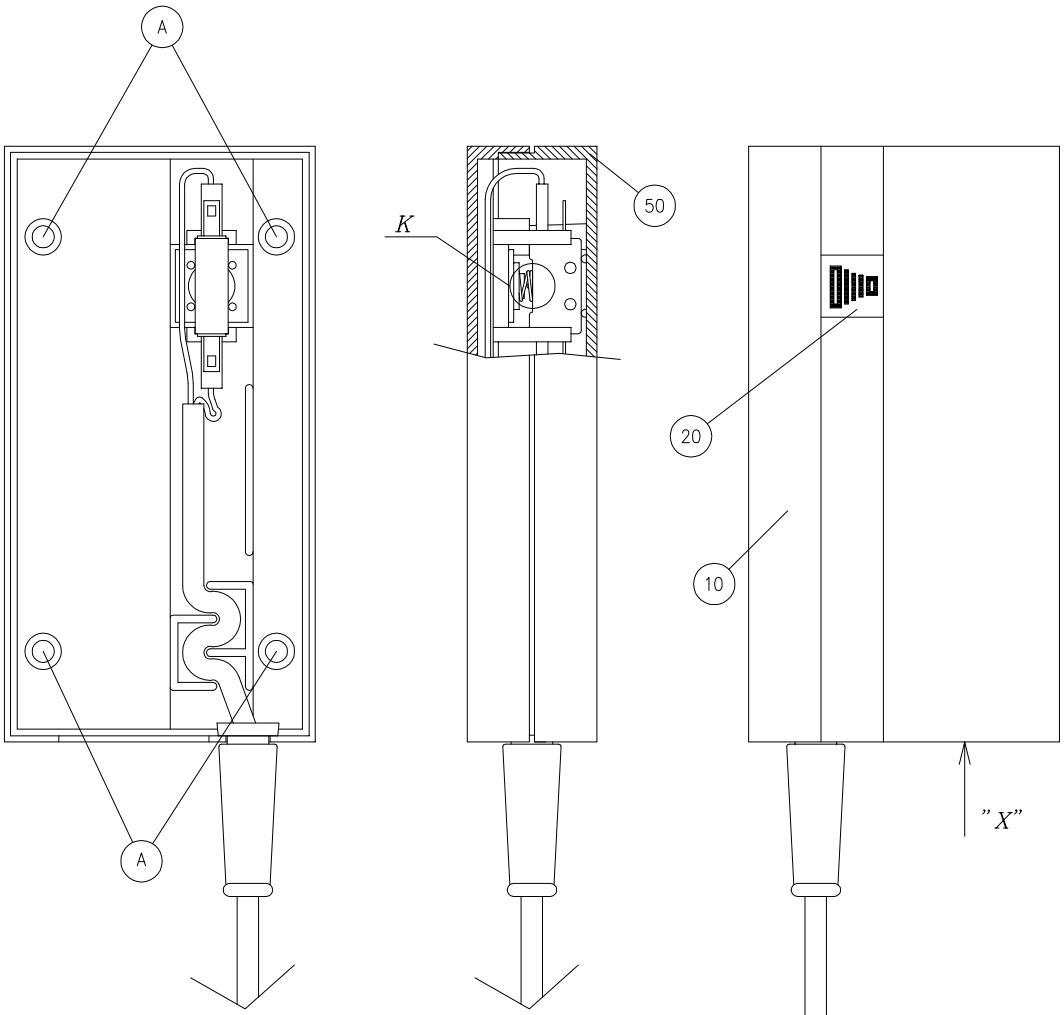



① CHIUSURA SEMISCATOLE (POS. 10 E 50)

SERRARE LE DUE SEMISCATOLE IN PROSSIMITA' DEI 4 ANCORAGGI "A" SINO A FAR SCATTARE I 4 DENTINI LATERALI NELLE RISPETTIVE TACCHE.
LA VERIFICA DEL CORRETTO SERRAGGIO SARA' FATTA INTRODUCENDO IL DITO DI PROVA (CEI 62-5) NELL'APERTURA INFERIORE "X" CON UNA FORZA DI 30N MAX, SENZA CHE AVVENGA L'APERTURA DELLE SEMISCATOLE



PART. K
Scala 3:1

POS.	N° DISEGNO	Q.
50	54087058	1
40	62603727	1
30	57087060	1
20	54087059	1
10	54087057	1

VILLA SISTEMI MEDICALI

rugosita' * | trattamento termico e/o superficiale * * * | materiale * * | scala * 1:1

ELIMINARE EVENTUALI BAVE. SMUSSI NON QUOTATI: * *

QUOTE SENZA INDICAZIONI DI TOLLERANZA: tolleranze per dimensioni lineari J14, fori H13, alberi h13, valori angolari ±30'. | proiezione

rev.	n.d.m.	descrizione modifica	data	firma
2	4479	MOD. DIS. SOSTITUITI TERMINALI	21.12.98	
1	4367	MOD. DIS. AGGIUNTO NOTA	16.07.98	

sostituisce il * data * firma * | DIS. data 10.12.97 firma

codice CAD * | APPR. data 21.12.98 firma

denominazione: PULSANTE RAGGI COMPLETO

foglio * di * fogli | n°disegno 62603725

TUTTI I DIRITTI RISERVATI.